Samodzielny Publiczny
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz
tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2018 r.

Znak sprawy: ***10/2018***

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę leków, płynów infuzyjnych, , preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych.”.** Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2018/S 115-261253** z dnia 19 czerwca 2018 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1
Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz **różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania** np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, należy wskazać konkretną pozycję w pakiecie.

Pytanie 2
Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku
Odpowiedź:
Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 3
Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 4
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę w przypadku gdy zaoferowana wielkość opakowania nie przekracza dwukrotnej ilości w odniesieniu do opakowania z SIWZ. Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie?
Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek (w tym kapsułek twardych, elastycznych, miękkich) i odwrotnie.

Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. ?
Kapsułek (w tym twardych, elastycznych, miękkich) zamiast drażetek i odwrotnie.?
Tabletek zamiast tabletek powlekanych ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5
Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów :
fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawki i odwrotnie ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6
Czy Zamawiający podając jako postać tabletki ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek ?
(zwykłe , powlekane, drażowane)?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 6
Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na wycenę w ostatniej cenie i umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?
Odpowiedź:
Należy podać ostatnią cenę oraz umieścić odpowiednią adnotację pod pakietem.

Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 6)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Acidum acetylsalicylicum 300 mg * 10 tabl - 24 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 20, 237, 238, 277, 346, 476)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu , pozycji nr 20; 237; 238; 277; 346; 476 z pakietu 1 pakietu celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 23)
Pakiet 1 poz. 23 - Alkoholowy wyciąg z ziela ostróżeczki polnej i kwas octowy – Czy Zamawiający miał na myśli wycenę preparatu Delacet skład na 100g: Nalewka z ziela ostróżeczki – 96 g,
Kwas octowy 80% – 4 g. Zawiera 59,0-65,0% v/v etanolu, fl.100g?.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 42, 43)
Pakiet 1 poz. 42,43 -Amitriptylini hydrochloridum- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci tabletek powlekanych?. Tylko taka postać dostępna na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 50, 80, 81, 131, 330-332, 434, 435)
W nawiązaniu do ww. postępowania przetargowego, niniejszym zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 1, pozycji: 50,80,81,131,330-332, 434,435 i utworzenie odrębnego Pakietu dla w/w pozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 60)
Pakiet 1 poz.60 Benzyl benzoate – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu NOVOSCABIN PŁYN 120 ML?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78)
Czy w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78)
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) **wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?**
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78)
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?**
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78)
Czy w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) **Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?**
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, poz. 77, 78)
Czy Zamawiający w pakiecie Nr 1 poz.77 78 (BUDESONIDUM zawiesina do inhalacji 250 i 1000 mcg/2ml *20 amp./poj.) **wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (**Budesonidum) **i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?**
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, poz. 80)
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 pozycja 80, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem hiperbarycznym ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, poz. 80)
Czy Zamawiający w Pakiet nr 1 - Leki iniekcyjne, doustne i inne cz.I poz. 80 (Bupivacaine, 20 mg/ 4 ml 5 amp.) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?**
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, poz. 100)
Pakiet 1 poz.100 Carbo medicinalis - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Carbo Medicinalis w postaci kapsułek?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, poz. 100)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 100. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Węgiel Leczniczy ,200mg,kaps.twarde,20szt ? (Brak preparatu w postaci tabletek)
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, poz. 102, 103, 368, 491)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 102; 103; 368; 491 Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę wymaganych preparatów w postaci tabletek powlekanych ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107, 108)
Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 107 i 108 ma na myśli ceftazydym zachowujący stabilność w 2-8^{0}C przez 24h co umożliwi podanie kolejnym pacjentom, oszczędzając tym samym koszty leczenia ciężkich zakażeń szpitalnych?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107, 108)
Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 1 pozycja 107 i 108, aby zaoferowany Ceftazydym był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, poz. 107)
Czy zamawiający dopuszcza Ceftazydym 1g, w pakiecie 1 pozycja 107, którego podanie drogą infuzji wymaga bezwzględnego użycia aparatu do infuzji typu Y?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, poz. 110, 111)
Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym 0,75g i 1,5g, w pakiecie 1 pozycja 110 i 111, zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej:

-0,9% w/v roztwór chlorku sodu
-5% roztwór glukozy do wstrzykiwań
-0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań
-5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
-5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
-5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
-10% roztwór glukozy do wstrzykiwań
-10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań
-roztwór Ringera do wstrzykiwań
-mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań
-mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6)
-wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, poz. 110, 111, 112)
Czy zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 110 i 111 oraz pozycja 112, wymaga aby zaoferowany Cefuroximum w dawce 0,75g i 1,5g oraz w formie tabletkowej 0,5g, pochodził od jednego producenta co zapewni bezpieczeństwo i tolerancję terapii sekwencyjnej?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, poz. 111)
Czy zamawiający, w pakiecie 1 pozycja 111, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, poz. 115)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 115. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu zarejestrowanego jako suplement diety?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, poz. 123)
Pakiet 1 poz.123 Cholecalciferol - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci kapsułek twist-off?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, poz. 127, 128, 129)
Czy w pakiecie 1 pozycja 127, 128 i 129, Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny inj. w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) i gdy lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki pochodzące od jednego producenta?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, poz. 127, 128, 129)
Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycje 127, 128 i 129 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, poz. 132)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 132. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Citalopram, 20 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14) - 161 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, poz. 167)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 167. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simeticonum **0,04g** opakowanie 100 kps., posiadające takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonum 0,05 x 100 tbl.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, poz. 195)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 195. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml,emuls.do wstrz.,10amp?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, poz. 208, 209, 250)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 208; 209; 250. Czy Zamawiający dopuści wycenę wymaganego preparatu konfekcjowanego po 10 butelek (fiolek) z odpowiednim przeliczeniem ilości ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, poz. 212)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 212. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233)
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233)
Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233)
Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu zbiorczym przeliczeniem zamawianej ilości .
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, poz. 233)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 233 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 250. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, poz. 250)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 250. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, poz. 257)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 257. Czy Zamawiający dopuści wycenę wymaganego preparatu konfekcjowanego po 20 sztuk * 6 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264)
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 264 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzą wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus acidophilus (La-5), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27), Bifidobacterium lactis (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264)
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,

przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* (analog *L. acidophilus*, gatunek stosowany również w produkcie oryginalnym) w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt opisany w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 1, poz. 264)
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie TribioDr., będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie kompozycję trzech probiotycznych szczepów bakterii kwasu mlekowego: *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus delbueckii subsp. bulgaricus* i *Bifidobacterium lactis* w łącznym stężeniu 1,6 x 10^9 CFU/kaps, w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 1, poz. 268)
Pakiet 1 poz.268 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Probiodr kapsułki twarde x 60?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 1, poz. 280)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **produktu równoważnego** <LIDOCAINE H/CHL. + CHLORHEXIDINUM GLUCONICUM soln. 20% + HYDROXYBENZOESAN METYLU+HYDROXYBENZOESAN PROPYLU 2g + 0,25g + 0,06g+ 0,025g / 100g> w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką **o pojemności 11ml (13g)?**
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 1, poz. 280)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 280. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Lubragel,żel,sterylny,z lidokainą,11 ml, 25strzyk. * 48 op?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 1, poz. 288)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 288. Czy Zamawiający wyrazi zgode na wycenę preparatu Levofloksacyna, 500 mg, tabl.powl., 10 szt * 3 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 1, poz. 291)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 291. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 1, poz. 291)

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 291. Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 1, poz. 318)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 318. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Mianserinum, 30 mg, tabl.powl.,30 szt,blist. * 14 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 1, poz. 346)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 346. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Neomycinum Jelfa, 0,5%, maść do oczu, 3 g ? (brak preparatu w dawce 0,01)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57(dot. Pakiet nr 1, poz. 368)
Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. Nr 368 ma na myśli Hepatil*40 tabl (skład 100 mg Ornityny i 35 mg Choliny)?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 1, poz. 373)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 373. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 1, poz. 409)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 409. Czy Zamawiający dopuści wycenę 42 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 1, poz. 419, 420, 421)
Pakiet 1 poz.419,420,421 Promazini hydrochloridum - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci drażetek?. Tylko taka postać dostępna na rynku.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 1, poz. 449)
Pakiet 1 poz.449 Rocuronii bromidum – Proszę o sprecyzowanie, czy należy wycenić preparat w dawce 10 mg/ml 10 fiol. 5 ml?
Odpowiedź:
Fiolki po 10ml.

Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 1, poz. 454)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 454. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu zarejestrowanego jako Środek spoż. specj. przezn. Med. ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 1, poz. 454)
Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, występującym w takiej samej postaci, zawierającym w swoim składzie identyczne stężenie probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce (250 mg).
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 1, poz. 459)
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści preparat Sevofluranu- Sojourn firmy Bioton w butelce szklanej 250 ml wyposażonej w system wlewowy tj. konektor wielokrotnego użytku (konektor nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników), wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego?
Gwarantujemy również bezpłatny serwis i przegląd parowników przynajmniej raz w roku w ramach umowy
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 1, poz. 460)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 460. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 1, poz. 479)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 479. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f - 2 op.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci pasków testowych GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków testowych); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe do glukometru charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru podawany w jednostkach 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów glikemii u osób dorosłych i noworodków, przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) enzym oksydaza glukozy GOD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych nie wymagających kodowania za pomocą kluczy kodujących, chipów lub pasków kodujących?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie informuje, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 1, poz. 480)
Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 1, poz. 488)
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 488. Czy Zamawiający dopuści wycenę Spiriva,18 mcg/dawkę, prosz.d/inh.w kaps.tw,90 szt * 1 op.?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 3 pozycji 19 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19)
Czy Zamawiający, w pakiecie 3 pozycja 19, wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania jednostkowego x 1 fiolka, zachowując oczywiście podaną ogólną wymaganą ilość?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 3, poz. 19)
Czy Zamawiający, w pakiecie 3 pozycja 19, wymaga aby, Cefazolin 1g zgodnie z ChPL produktu leczniczego posiadał rejestrację do przechowywania także w temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 3, poz. 39, 40)
Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 3 pozycje 39,40 zarejestrowane wskazanie do podania doustnego (stosowane w leczeniu rzekomobłoniastego oraz gronkowcowego zapalenia jelit)?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 6, poz. 3)
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli w zakresie zadania nr 6 poz. 3: worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z oliwek), elektrolity, azotu 9g/L, o współczynniku Q 93, pojemność worka 1000 ml?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 6, poz. 4)
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli w zadaniu nr 6, poz. 4: worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do żyły głównej, zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze (na bazie 80% oliwy z oliwek), elektrolity, azotu 9 g/L, o współczynniku Q 93, pojemność worka 1500 ml?
Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 9, poz. 8)
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8. Czy Zamawiający w zadaniu 9 poz. 8 (Apixaban 5 mg x 56 tab), dopuści zaproponowanie leku Apixaban tab. powlekane 5 mg. opak. 60 tab.?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 9, poz. 28)
Dotyczy pakietu nr 9 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Enema, roztw.do wl.doodbytn, 150 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 11, poz. 14, 15)
Czy zamawiający wymaga aby, zgodnie z ChPL cefuroksym 1,5g w pakiecie 11 pozycja 14 i 15 wykazywał zgodność z metronidazolem (500mg/100ml) i działanie obu składników utrzymywało się do 24 godzin w temperaturze poniżej 25 C?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 13, poz. 20)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 pozycja 20 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w rozworze elektrolitów w opakowaniu worek 500ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 15, poz. 17)
Czy zamawiający w pozycji 17 dopuszcza wycenę preparatu niskotłuszczowego – o zawartości 70% tłuszczów MCT?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 16, poz. 1, 2)
Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomiczne gospodarowanie powierzonymi środkami publicznymi i zasadę zachowania wolnej konkurencji, wyłączy z ***Pakietu nr 16 nr poz. 1 i 2*** *i utworzy z niej osobny pod pakiet 16a, lub dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje, co pozwoli na zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych?*
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 46,7% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin

Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 16, poz. 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11)
Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11)
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR i 14Fr o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038'', dwa koreczki heparynizowane.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 16, poz. 11)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3)
Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3)
Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?
Rozmiar 1 - 9mm x 10mm
Rozmiar 2 – 13mm x 15mm
Rozmiar 3 - 13mm x 15mm
Rozmiar 4 - 13mm x 15mm
Rozmiar 6 - 13mm x 15mm
Rozmiar 8 - 13mm x 15mm
Rozmiar 10 - 13mm x 15mm
Rozmiar 14 - 13mm x 15mm
Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1, 2, 3)
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.
Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 17, poz. 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 6,5-13,5cm w stanie swobodnym, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 17, poz. 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 5,0-9,5cm w stanie swobodnym, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 17, poz. 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki elastycznej o szerokości 1,0-2,5cm w stanie swobodnym, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 17, poz. 4, 5)
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 17, poz. 6, 7)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wadze różniącej się +/- 10% od podanej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 17, poz. 6)
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, nie jałowe, o wadze około 1,79 g, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 17, poz. 7)
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, nie jałowe, o wadze około 1,05 g, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 17, poz. 13, 14)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski tkanej o składzie: przędza bawełniana, przędza poliamidowa, wysokoplastyczna przędza poliuretanowa, pozostałe parametry jak w SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 17, poz. 13, 14)
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, pozostałe wymagania bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 17, poz. 15)
Czy zamawiający oczekuje/dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 17, poz. 16-25, 27, 28)
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 17 wydzieli pozycje: 16-25,27-28 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 17, poz. 17)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w op. a'30 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej a'2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26)
Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26)
Czy zamawiający dopuści wycenę za serwetę pakowaną po 1 szt., z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 17, poz. 26)
Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5)
Prosimy o wydzielenie poz.3-5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi

Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5)
Czy zamawiający dopuści kompres jałowy włókninowy 30 g/m2 – 4 warstwowe, pakowane po a'2 szt w blistrze x 25 szt. blistrów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 18, poz. 3, 4, 5)
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 18, poz. 9)
Czy Zamawiający dopuści produkt ZinoDr. o właściwościach barierowo-ochronnych, zawierający w swoim składzie tlenek cynku oraz specjalnie opracowany kompleks składników zabezpieczający skórę przed transepidermalną utratą wody oraz niezbędnych składników; działający gojąco oraz regenerująco na skórę wrażliwą i podrażnioną; konfekcjonowany w pojemnikach plastikowych z zabezpieczeniem, o masie 250 g odpowiadającej 200ml.?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 18, poz. 23)
Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o zaoferowanie 100szt. pieluchomajtek wciąganych w rozmiarze M, bowiem nie podano jednostki miary.
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 19, poz. 14)
Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek „superasorbent" (rozmiar 10cm x 10cm) zapobiegający infekcjom bakteryjnym. Opatrunki są odpowiednie dla różnych rodzajów ran, ponieważ nie uwalniają żadnej substancji do środowiska rany. Wykorzystują naturalny mechanizm wiązania mikroorganizmów do powierzchni opatrunku, dlatego wraz z jego zmianą zmniejszana jest ilość mikroorganizmów oraz patogenów często występujących w ranie takich jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Opatrunek działa również wobec szczepów MRSA (oporny na metycylinę Staphylococcus aureus) i VRE. Opatrunki dzięki swej innowacyjnej technologii mogą być stosowane jako profilaktyczna ochrona przed infekcją u wszystkich pacjentów - włączając dzieci oraz kobiety ciężarne. Mogą być również stosowane by bezpiecznie zmniejszać obciążenie biologiczne w krótko- i długoterminowym leczeniu zainfekowanych ran.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 19, poz. 14)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 z Pakietu nr 19 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1)

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta 2-w do artroskopii 200 x 320 cm, otwór 5 i 5 x 7 cm, worek na płyny i uchwyt Velcro
1 x fartuch chirurgiczny standard M
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
1 x cewnik Nelatona 10/3,33 CH/mm 40 cm
2 x osłona na kable video 13 x 250 cm, tekturowa prowadnica, teleskopowo złożona
1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana
20 x kompresy z gazy RTG 7,5 x 7,5 cm 16 warstw 17 nitek
1 x bandaż elastyczny 15 cm x 5 m, wysoka kompresja
1 x podkład pod gips 15 cm x 3 m
2 x taśma przylepna 10 x 50 cm
dodatkowo odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia w fartuchach chirurgicznych wzmocnionych min. 165cm H2O
pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1)
Czy w pozycji „serweta na pośladki dwuwarstwowa 100 x 120 z jednym workiem do zbiórki płynów" nie nastąpiła omyłka pisarska w ilości serwet. Czy zamawaiający oczekuje jednej sztuki czy dwóch.
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje 1 szt.

Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1)
Czy w pozycji kompres z włókniny 10 x 10 cm Zamawiający dopuści kompres 30g/m2. Pozostały opis zgodny z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 serweta 75 x 80 cm 2-warstwowa na całej powierzchni
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 75 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 15cm

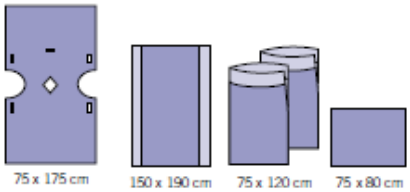

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 168 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta na stół do instrumentarium 100 x 150 cm
- 2 legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
- 1 serweta do cystoskopii 100 x 175 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z przylepnym otworem 9 x 15cm

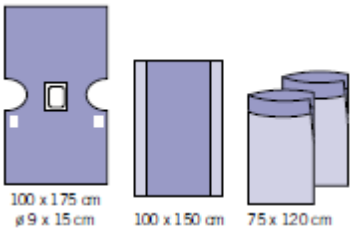

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 168 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania

wysokie. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu). Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 23, poz. 1)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rozmiaru serwety do cystoskopii 175 x 90 cm z otworem lepnym 9 x 15 cm, serwety na stolik instumentariuszki w rozm. 120 x 140 cm i 2 nogawice 75 x 120 cm, bez serwetek do rąk?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2)
Pakiet 23, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z powyższego pakietu i utworzenie osobnego pakietu, co powoli Nam złożyć korzystną ofertę dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2)
Pakiet 23, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczeni do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym opisie:
Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego materiału (laminat folii PE i włókniny PP) o gramaturze serwet 62g/m^2. W skład zestawu wchodzą:
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m^2.
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30 g/m^2, folia PE 0,050mm,
- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m^{2}o wym. 90x100cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66 g/m^2

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795, .na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Całość zestawu zawinięta w serwetę na stolik instrumentalny.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 23, poz. 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 2 niżej opisanego zestawu?
- 1 Serweta główna w kształcie litery "T" 186/250 cm x 330cm .Serweta główna musi posiadać otwór w okolicach jamy brzusznej 36cm x 36cm wypełniony folią operacyjną z oknem 18x16cm, zintegrowaną torbę na płyny.
- 1 Serweta dla noworodka 75 cm x 120 wykonana z włókniny bawełnopodobnej
- 1 serweta na stół instrum. 190cm x 150cm
- 1 serweta na stolik Mayo 145cm x 78cm ze wzmocnieniem
- 4 serwetki do rąk 30,5cm x 34cm
- 1 taśma mocująca 9x50cm

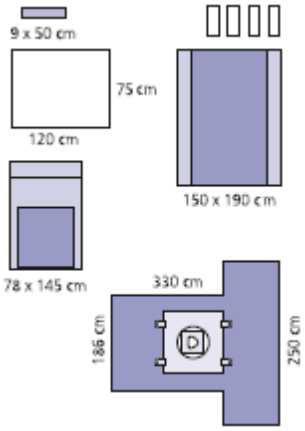

Serweta główna wykonana w całości z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie.
Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu).
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

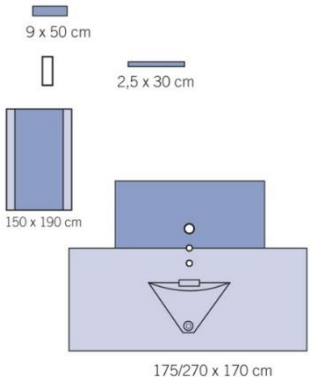

Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (hydrofilowa włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na mokro 168 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Na opakowaniu cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu).
Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów oraz wyraźnie oznaczony środek serwety głównej np. strzałką.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 23, poz. 3)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w zestawie do zabiegów urologicznych rzepu w rozm. 2,5 x 24 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 23, poz. 4)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 4 taśmy przylepnej VELCRO jałowej 2,5 x 30 cm z warstwą klejącą zabezpieczoną papierem silikonowanym. Wyrób zgodny z normą EN 13795-1,2,3
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 23, poz. 5)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 poz. 5:
Serweta w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z niebieskiej folii polietylenowej piaskowanej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu (PE+PP). Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 140 g/m2. Wielkość wzmocnienia 65 cm x 85cm.
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795
Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające min. nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane jednoznacznie identyfikujące producenta (nazwa brandu).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 24, poz. 1)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do laparoskopii –ginekologii w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm
z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm
z otworem na krocze 10 cm x 15 cm
z osłoną podpórek kończyn górnych
ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów
oraz dodatkowo serweta dwuwarstwowa 75 x 90 cm pod pośladki
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa
i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 24, poz. 2)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min.57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych w składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm
1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm
Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 340%
(wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada
2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 24, poz. 3)
poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdują się 4 serwetki do rąk? Pozostałe elementy i wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza 4 serwety do rąk.

Pytanie 136 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4)
poz. 4: Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwetki do rąk mają wymiary 40 x 20 cm? Pozostałe elementy i wymagania zgodnie z SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 138 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

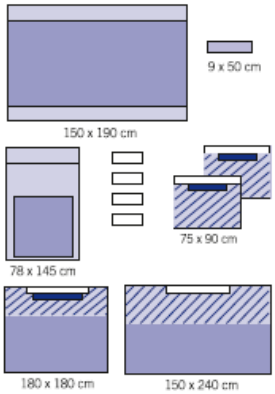

• 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
• 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
• 4 ręczniki do rąk
• 2 przyklejane serwety 3-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta średnia (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm
• 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3-warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm)
• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Serweta na stół instrumentalny - folia polietylenowa i warstwa chłonna (PE+PP) (chłonność warstwy min. 400%).
Serweta na stolik Mayo - folia polietylenowa i warstwa chłonna (PE+PP) (chłonność min.470%), serweta składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, posiada piktogramy ułatwiające poprawną aplikację, rozmiar warstwy chłonnej min. 85x65cm serwety laminowane nie powodują drażnienia, uczulenia
Cały asortyment spełnia wymogi E-PN 13795 1-3.
Cały asortyment sterylizowany w walidowanym procesie, zgodnie z normą:
- dla tlenku etylenu 11135-1;
Każdy zestaw obłożeniowy zaopatrzony w etykietę w języku polskim umieszczoną na zewnątrz opakowania oraz cztery etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia w karcie zabiegu, zawierające min: serię, datę ważności i symbol artykułu.
Włóknina trójwarstwowa - włóknina foliowana 2 warstwy włókniny polipropylenowej i 1 warstwa folii polietylenowej. gramatura 75g/m2, dodatkowe łaty chłonne o gramaturze 80g/m2, całkowita gramatura w części wzmocnionej 155g/m2. chłonność min. 820%, odporność na przenikanie cieczy 167 cm H2O.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 139 (dot. Pakiet nr 24, poz. 4)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego, trójwarstwowego w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
4 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm
1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm z paskiem samoprzylepnym dzielonym o długości 100 cm (15 cm, 70 cm, 15 cm)
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 74 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 330% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140 (dot. Pakiet nr 24, poz. 5)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie obłożenia do zabiegów dłoń/stopa w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6)
2 ręczniki 30 cm x 40 cm ze wzmacnianej włókniny celulozowej

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, (zdolność absorbcji cieczy > 100% wg EN ISO 9073-6) serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów
i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa
i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm +/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m2. Zdolność absorbcji cieczy min. 370% (wg ISO 9073-6), odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej osłony na kończyny dolne w rozm. 75 x 120 cm, pakowane po 2 szt. Osłona na kończynę dolną (nogawica) wykonana jest z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142 (dot. Pakiet nr 24, poz. 6)
poz. 6: Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o wymiarze 80 x 140 cm, wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2, zapakowane w torebkę papierowo – foliową, opakowanie zaopatrzone w 2 etykiety zawierające LOT, datę ważności, nr katalogowy oraz dane wskazujące na wytwórcę? Wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7)
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2.Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów.
Rozmiar fartucha to jego długość - 120 cm (M), 130cm (L), 150 cm (XL).
Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2, na rękawach 40,5 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy przód/rękaw 123/194 cm H2O.
Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, mankiety wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144 (dot. Pakiet nr 25, poz. 1)

Pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie :

2 rękawice diagnostyczne – nitrylowe Fino – bezpudrowe – rozmiar M
1 serweta 45 x 75 cm– wykonana jest z podwójnej włókniny (celuloza i polietylen) –o gramaturze 55 g/m²
1 serweta 60 x 60 cm – z otworem 5 cm i rozcięciem– wykonana jest z podwójnej włókniny (celuloza i polietylen) – 55 g/m² -

1 kleszczyki typu Kocher
1 pęseta anatmiczna
5 kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm
4 tampon gazowy (tupfer) - wielkość śliwki wykonanyw 100% chłonna gaza bawełniana - 20-nitkowa
1 żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny - 2,7 g
1 strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 145 (dot. Pakiet nr 25, poz. 2)
Pakiet 25
Pozycja 2 – Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do zdjęcia szwów o składzie:
1 pęseta 12,5 - zielona
1 cienkie nożyczki ostre/ostre 11,5 cm - proste - tępe
1 pęseta Adsona z nakrywką zabezpieczającą 12 cm - prosta - bez ząbków - tępa
3 kompresy gazowe 17-nitkowej - 8-warstwowej - 7,5 x 7,5 cm

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146 (dot. Pakiet nr 25, poz. 3)
Pakiet 25
Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu jałowego do wkłucia lędźwiowego o składzie:

1 serweta ochronna 75 x 90 cm - wykonana jest z podwójnej włókniny (polipropylen i polietylen) – o gramaturze 55 g/m2
1 serweta epiduralna 75 x 90 cm – z otworem centralnym 15x13 i przylepną krawędzią boczną ; wykonana jest z podwójnej włókniny (celuloza i polietylen) - 50 g/m2
1 samoprzylepny opatrunek, z centralnym wkładem chłonnym- 7,2 x 5 cm
1 kleszczyki typu Kocher 14 cm
1 strzykawka Luer-lock - 5 ml (zapakowana)
1 igła do iniekcji podskórnych 22G (nr 0,7x30mm) (zapakowana)
1 igła do iniekcji podskórnych 18G (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
6 kompresów gazowych o wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm

Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 147 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g. o smaku cytrynowym, będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy; oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148 (dot. Pakiet nr 27, poz. 8)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75 g. będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE WZORU UMOWY

Pytanie 149
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 150
Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 6 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 151
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §2 ust.3, §3 ust.8 i §3 ust.12 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Wbrew twierdzeniom pytającego Zamawiający właśnie w §3 ust. 8 wskazał zakres takiej zmiany, ponadto należy zaznaczyć iż Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, gdyż jest wysoce nieprawdopodobne aby określić ilu pacjentów i z jakimi schorzeniami będzie korzystało z usług Zamawiającego.

Pytanie 152 (dot. § 2 ust. 8)
Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.8? Zapis o 'odmowie przyjęcia towaru" jest sprzeczny z prawem, gdyż pozbawia dostawcę możliwości ustosunkowania się do reklamacji, poprzez wprowadzenie jednostronnej procedury 'odmowy przyjęcia'. Wszystkie reklamacje winny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. przy udziale Wykonawcy.
Odpowiedź:
Treść § 2 ust. 8 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 153 (dot. § 2 ust. 10)
Do treści §2 ust.10 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie warunku o treści: "..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."
Odpowiedź:
Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 154 (dot. § 3 ust. 2)
Czy zamawiający zmieni treść par. 3.2. nadając mu brzmienie „Wykonawca gwarantuje stałość cen **netto** przez okres trwania umowy." Obecne brzmienie zapisu przenosi na wykonawcę ryzyko w przypadku zmian stawek podatku VAT.
Odpowiedź:
Treść § 3 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 155 (dot. § 3 ust. 5)

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §3 ust.5 projektu umowy)?
Odpowiedź:
Treść § 3 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 156 (dot. § 3 ust. 7)
Czy Zamawiający w par. 3.7 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w razie zmiany przepisów, bez dodatkowej zgody Zamawiającego? Taki warunek grozi Wykonawcy rażącą stratą – w razie podwyższenia podatku VAT, na co Zamawiający się nie zgodzi.
Odpowiedź:
Treść § 3 ust. 7 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 157 (dot. § 3 ust. 11)
Do treści §3 ust.11 projektu umowy prosimy o dodanie słów, zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c. "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź:
Treść § 3 ust. 11 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 158 (dot. § 3 ust. 12)
Zważywszy na treść § 3 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?
Odpowiedź:
Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 12 głównych postanowień umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 159 (dot. § 5 ust. 1)
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 5.1 poprzez zmianę wartości kary umownej z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 160 (dot. § 5 ust. 1)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowo *„opóźnienia”* zostało zastąpione słowem *„zwłoki”*?
Odpowiedź:
Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 161 (dot. § 5 ust. 1)
Do §5 ust.1 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru czy wadliwie dostarczonego poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia?
Odpowiedź:
Treść § 5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Pytanie 162 (dot. § 8 ust. 1)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?*
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 163 (dot. § 8 ust. 3)
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów par. 8.3 poprzez zmianę wartości kary umownej z 10% do wartości max. 5% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.? Kara umowna w tej kwocie jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź:
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian

Pytanie 164 (dot. § 8 ust. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §8 ust.3 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy?
Odpowiedź:
Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian

Pytanie 165 (dot. § 8 ust. 3)
Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie *„10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1"* zostało zastąpione wyrażeniem *„10% wartości niezrealizowanej części umowy"*?
Odpowiedź:
Treść § 8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.

Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03.08.2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.08.2018 r. o godz. 10:00.

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl**, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Z-ca Głównego Księgowego
SP WZOZ MSWiA Bydgoszcz

mgr Kamilla Dombrowska
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej